

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

■実施日 平成 23年4月1日(金)ご依頼分より

■変更項目および変更内容


案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
22	1010 3J010	総ビリルビン	測定方法	バナジン酸酸化法	安定化ジアゾニウム塩法	測定試薬変更の為
	1011 3J010	直接ビリルビン				
53	5404 5F019	HBe抗体 (CLEIA)	基準値	%INH 50.0%未満(-)	%INH 60.0%未満(-)	測定試薬変更の為
			検体量	血清0.3mL	血清0.5mL	
62	4309 4F025	血中エスト ラジオール 非妊婦 (E ₂)	基準値	下記参照	下記参照	測定試薬変更の為
			報告下限	11.8以下 pg/mL	10.0以下 pg/mL	
65	4353 5C065	β2-マイク 血中 ログロブリン — (BMG) 尿中	測定値	裏面参照	裏面参照	測定試薬変更の為 (この変更に伴う・検査方 法・基準値等の変更はご ざいませぬ)
	4354 5C065					
66	4355 5D410	神経特異エノラーゼ (NSE)	基準値	16.3以下 ng/mL	12.0以下 ng/mL	基準値見直しの為 (臨床検査提要の基 準値へ変更)

■血中エストラジオール基準値 (pg/mL)


		新	現
非妊婦	卵胞期	19.5~144.2	10~232
	排卵期	63.9~356.7	45~437
	黄体期	55.8~214.2	31~254
	閉経後	32.2以下	47以下
男性		39.8以下	42以下

裏面もご確認下さい

●総ビリルビン 現行試薬との相関

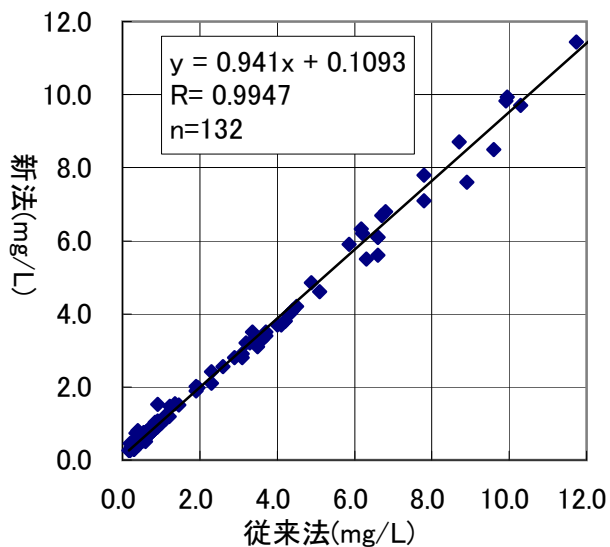

●直接ビリルビン 現行試薬との相関

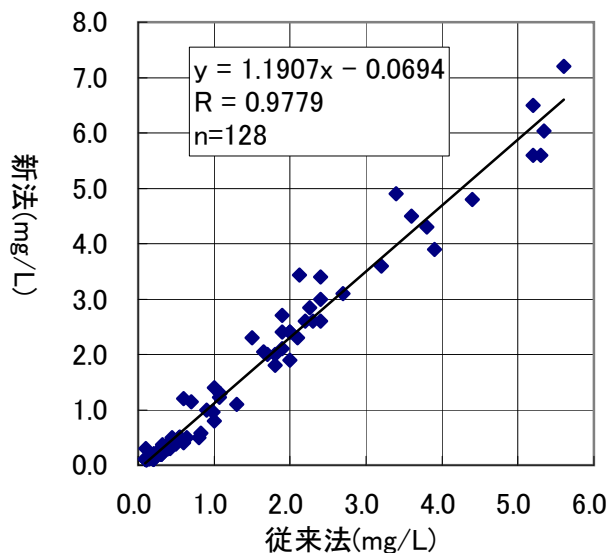


●HBe抗体 現行試薬との相関


		新試薬		合計
		+	-	
現行試薬	+	208例	1例	209例
	-	2例	319例	321例
	合計	210例	320例	530例

陽性一致率 : 99.0% (208/210例)
 陰性一致率 : 99.7% (319/320例)
 定性一致率 : 99.4% (527/530例)


●E2 現行試薬との相関

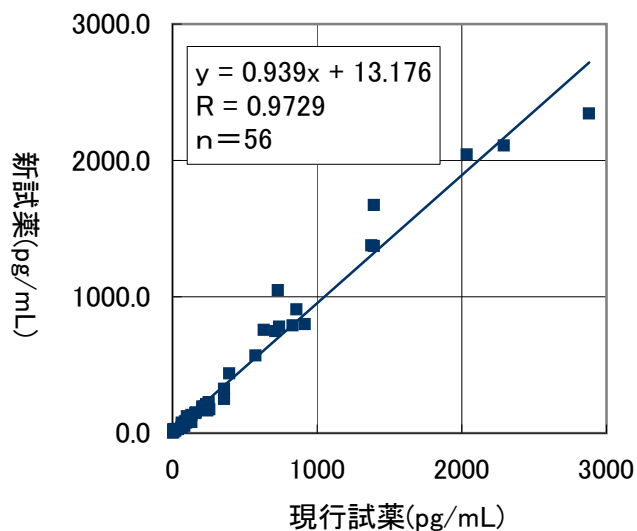

●血中BMG 現行試薬との相関

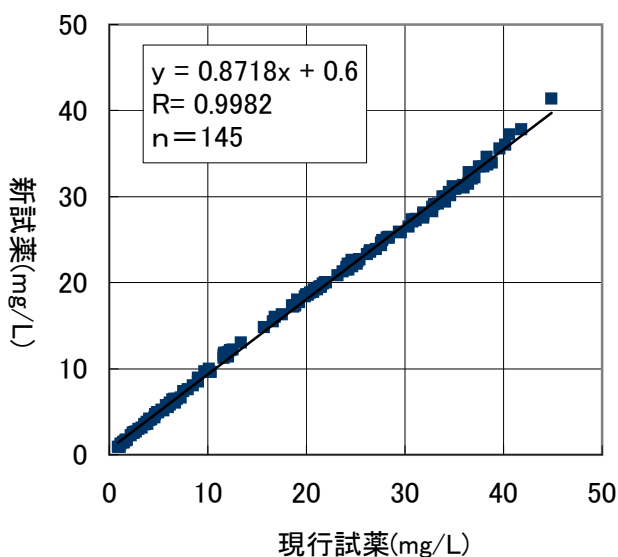

●尿中BMG 現行試薬との相関

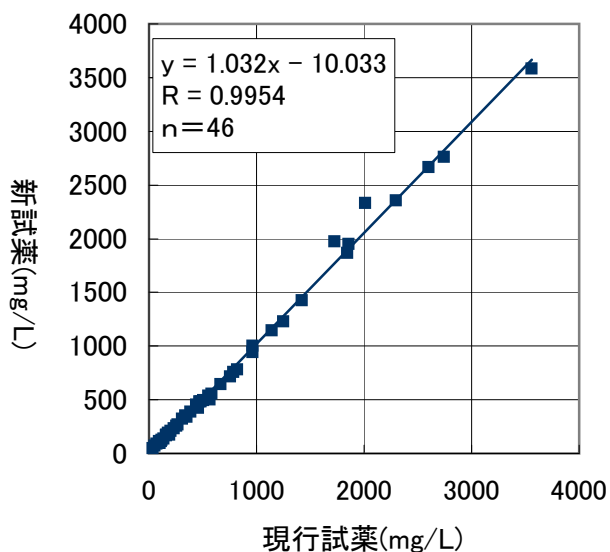

ご不明な点等がございましたら貴院担当営業もしくは当社お客様窓口までお申し付けください。