

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白



記

■実施日 平成 27年 5月 1日(金)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
57	4575 5J228	TARC	検査方法	CLEIA法	EIA法	現状試薬発売 中止に伴う変 更
			報告下限値	100pg/mL未満	125pg/mL未満	
			所要日数	2～3日	2～8日	
74	4111 4B040	サイログロブリン	基準値	33.70ng/mL以下	32.7ng/mL以下	現状試薬発売 中止及び改良 試薬への変更
			報告形態	小数2位	小数1位	
			報告下限値	0.04ng/mL未満	0.1ng/mL以下	

■相関

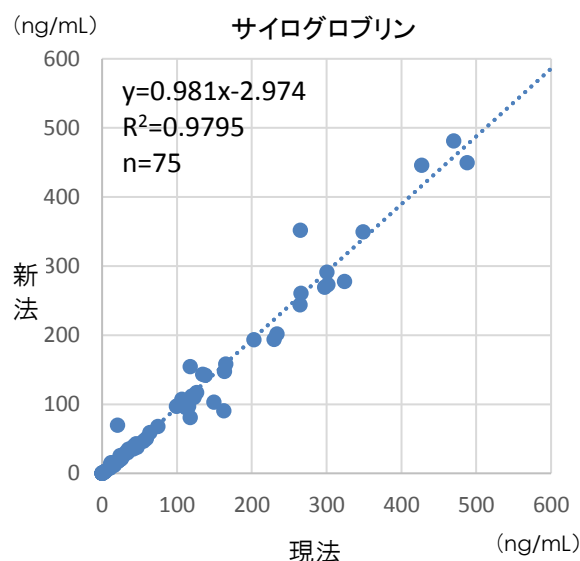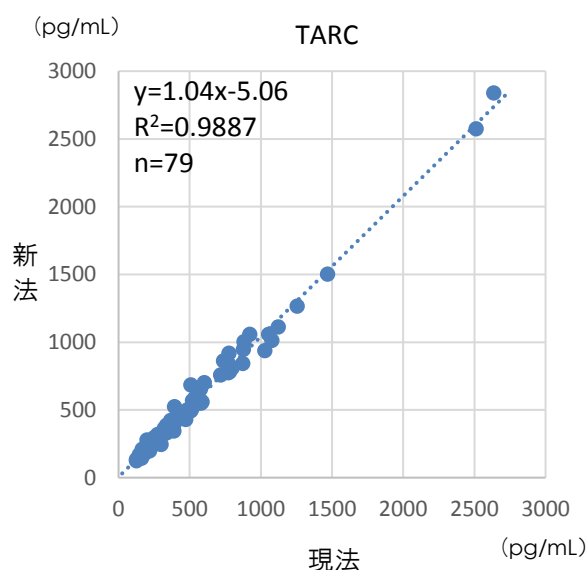

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。